




Dessin d'assemblage

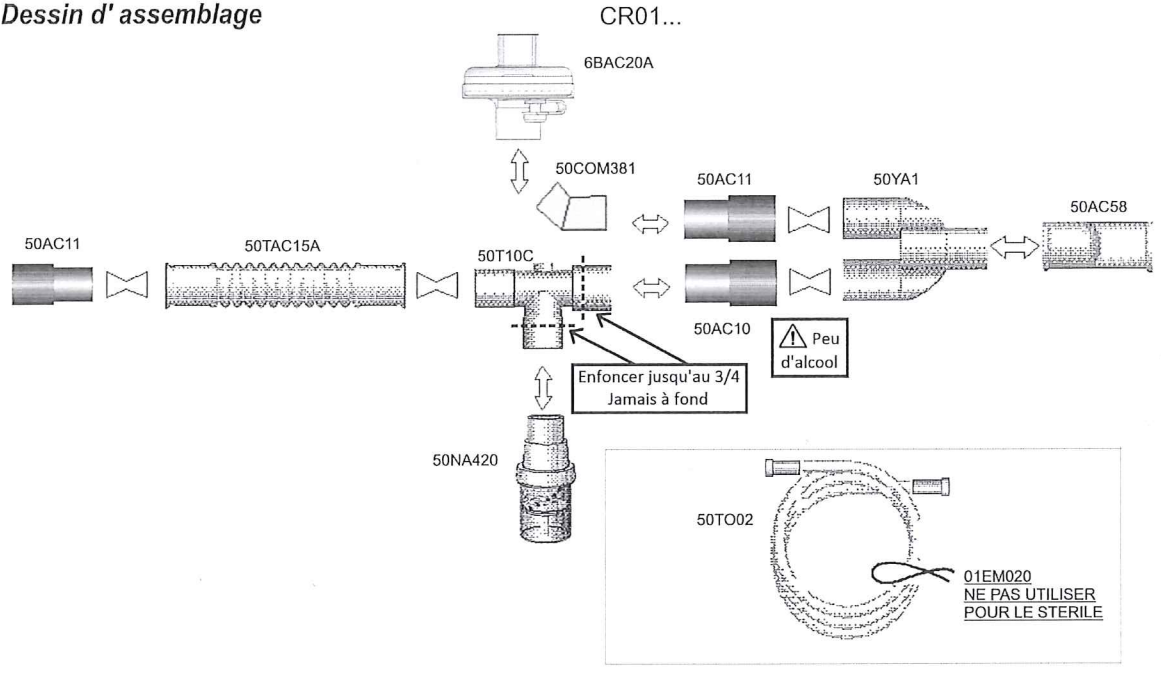

Int'Air Médical			
Indice :	Dessiné par :	Date :	Validé par :
DA.293.08	A.GUILLET	21/06/2017	P.Pelletier

Übersetzen

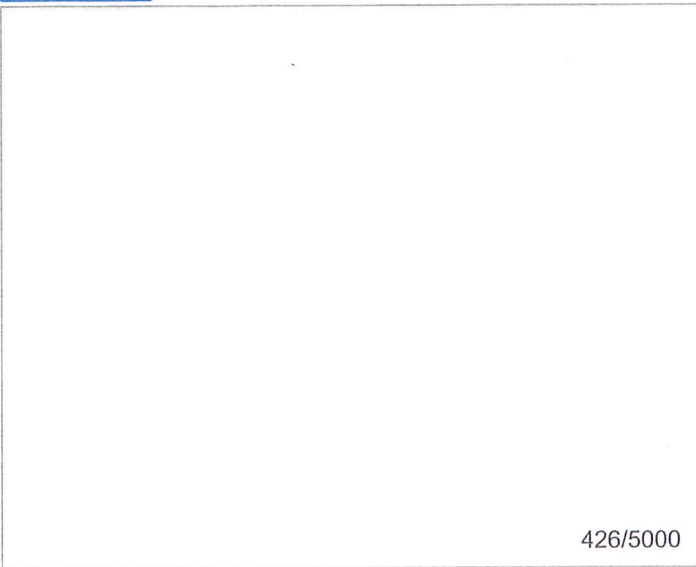

✓ 104

Jedoch ist diese Referenz CR01 / 1 nicht mehr gegeben. Dieses Produkt wurde fallen gelassen, als wir unsere CE-Zertifikate erneuerten. CR01 / 1 wird durch die neue Version von CR01 ersetzt, die dieselben Funktionen hat (nur das Aussehen des Y-Steckers unterscheidet sich).

Anbei eine Zeichnung des CR01.

Bitte können Sie überprüfen und lassen Sie uns wissen, wenn Sie diese Referenz CR01 genehmigen.

Zu Ihrer Verfügung für weitere Informationen, die Sie benötigen könnten.